SmartEP ASSR OAE VRA
INTELLIGENT HEARING
SYSTEMS
6860 SW 81st Street Miami, Florida 33143
305-668-6102 ▪ 1-800-IHSYSTEMS ▪ www.ihsys.com

XX XX
ID: XX Page: Acq Test Date: Jun. 04, 2024 DOB: Age: (DOB empty) Report: Jun. 04, 2024
Acquisition Page

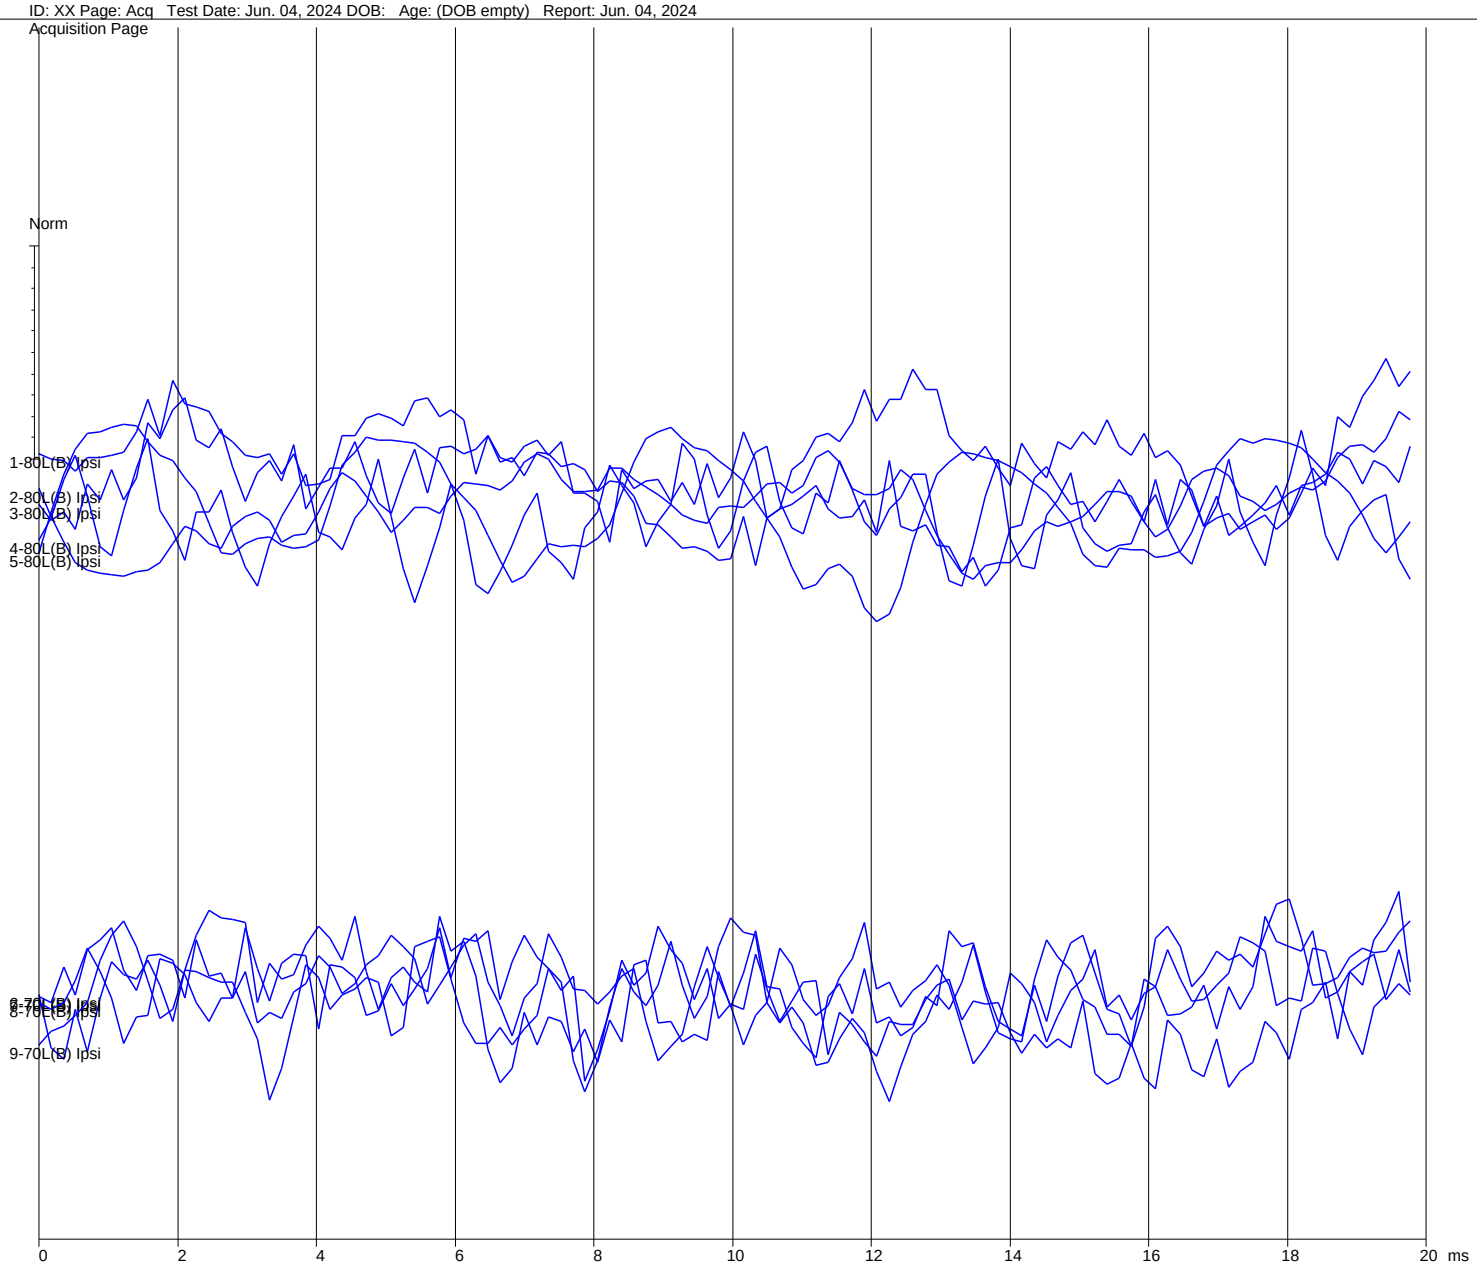

Num	Filename	Int	Ear	Stim.	Type	Swps/Art	Rate	Mode	PP Amp	SNR	RN	Gain	Filters
1	LXLA80B.5	80SPL	L	Bone	8000Hz(1)	560/1	11.4	Altr	0.53	0.05	3.104	100	100-1500Hz
2	LXLA80B.1	80SPL	L	Bone	8000Hz(1)	560/0	11.4	Altr	0.90	0.02	7.763	100	100-1500Hz
3	LXLA80B.2	80SPL	L	Bone	8000Hz(1)	560/0	11.4	Altr	0.40	0.03	3.118	100	100-1500Hz
4	LXLA80B.3	80SPL	L	Bone	8000Hz(1)	560/1	11.4	Altr	0.72	0.09	2.819	100	100-1500Hz
5	LXLA80B.4	80SPL	L	Bone	8000Hz(1)	560/1	11.4	Altr	1.62	0.07	10.890	100	100-1500Hz
6	LXLA70B.2	70SPL	L	Bone	8000Hz(1)	560/1	11.4	Altr	0.43	0.19	1.017	100	100-1500Hz
7	LXLA70B.3	70SPL	L	Bone	8000Hz(1)	560/1	11.4	Altr	0.39	0.11	1.180	100	100-1500Hz
8	LXLA70B.1	70SPL	L	Bone	8000Hz(1)	560/1	11.4	Altr	0.63	0.14	1.074	100	100-1500Hz
9	LXLA70B.4	70SPL	L	Bone	8000Hz(1)	560/0	11.4	Altr	0.50	0.15	1.141	100	100-1500Hz

System SNR & RN Region: 4.00 - 9.00 ms *-indicates different region used

Num	Int	Ear	Peaks: Latency(ms) | Amp(uV) (AR=Amp Ratio)
1	80	L	
2	80	L	
3	80	L	
4	80	L	
5	80	L	
6	70	L	
7	70	L	
8	70	L	
9	70	L	